



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA  
Estado de Goiás



CERTIDÃO  
Certifico que nesta data foi  
publicado neste (a)  
Gonata P. Sol/2019  
com afiação no placard do município  
Corumbáiba 01/09/2019

ERRATA

EDITAL "REPUBLICADO" DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

Descrição detalhada do item 01 constante no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

Responsável pelo Placard

Onde se lê:

5. ITENS, QUANTITATIVO E AVALIAÇÃO ESTIMADA DE CUSTO

5.1. O custo estimado e as especificações mínimas são:

Item	Quant.	Especificações mínimas	Valor unitário estimado
01	01	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bomba de infusão universal (aceita todos os equipamentos com registro na ANVISA):</b> Bomba de infusão volumétrica linear, fabricação nacional, projetada para uso em infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável; tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; bomba compatível com equipamentos padrão de qualquer marca; alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função purgar; KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática da última infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe de proteção IPX4; alarmes com indicações sonoras (bip e voz); início da infusão; término da infusão; infusão da quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; configuração incorreta; velocidade de infusão anormal; sensor de gotas desconectado; alimentação externa desconectada; bateria fraca; volume de infusão de 1ml a 9.999ml; taxa de infusão modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h); modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min); taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h); taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h); oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg).</li></ul>	R\$9.113,33

Passa-se a ler:

5. ITENS, QUANTITATIVO E AVALIAÇÃO ESTIMADA DE CUSTO

5.1. O custo estimado e as especificações mínimas são:

Item	Quant.	Especificações mínimas	Valor unitário estimado
01	01	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bomba de infusão universal (aceita todos os equipamentos com registro na ANVISA):</b> Bomba de infusão volumétrica linear, fabricação nacional, projetada para uso em infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável; tela de LCD para ajustes e configurações; painel de LED's para registro de volume infundido; LED's indicadores de funcionamento; bomba compatível com equipamentos padrão de</li></ul>	R\$9.113,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA**  
Estado de Goiás

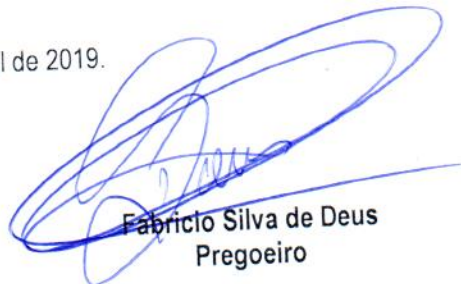


	qualquer marca; alarmes audiovisuais; sensor de gotas; ajuste de volume de infusão pré definido; modos de trabalho: ml/h e gotas/min; três níveis de indicação de oclusão no sistema; função purgar; KVO (manter veia aberta) com vazão ajustável de 1 a 5 ml/h; gravação automática da última infusão; funcionamento por mais de 4 horas em bateria; classe de proteção IPX1; alarmes com indicações sonoras (bip e voz); início da infusão; término da infusão; infusão da quantidade limitada encerrada; oclusão; detecção de bolhas; fechar a porta; instalação incorreta; configuração incorreta; velocidade de infusão anormal; sensor de gotas desconectado; alimentação externa desconectada; bateria fraca; volume de infusão de 1ml a 9.999ml; taxa de infusão modo ml/h – 1 a 1.200 ml/h (incremento de 1 ml/h); modo gotas/min – 1 a 266 gotas/min (incremento de 1 gota/min); taxas de BOLUS/Purgar: 100 a 1.200 ml/h (incremento de 100 ml/h); taxa de KVO: 1 a 5 ml/h (incremento de 1 ml/h); oclusão: Alta (800 mmHg), Média (500 mmHg), Baixa (300 mmHg).	
--	--	--

Permanecem inalteradas as demais condições do Edital, mantendo-se a data da apresentação das propostas, em virtude da ausência de prejuízo aos interessados, para o dia **05 de abril de 2019**, às **13:45 horas, com 15 minutos de tolerância, na Sede do Poder Executivo Municipal (Sala de Licitações e Contratos), situada à Rua Simon Bolívar, nº. 58, Centro, Corumbáiba-GO.**, conforme já publicado no Diário Oficial do Estado, no Jornal Diário do Estado, no site da municipalidade e no placar da Prefeitura Municipal de Corumbáiba.

Publique-se.

Corumbáiba, 1º de abril de 2019.

  
Fabricio Silva de Deus  
Pregoeiro